


EXIGENCES A SATISFAIRE POUR LA CONFORMITE DU PRELEVEMENT

PRELEVEMENT = tube(s) échantillon(s) + fiche de prélèvement+ prescription médicale

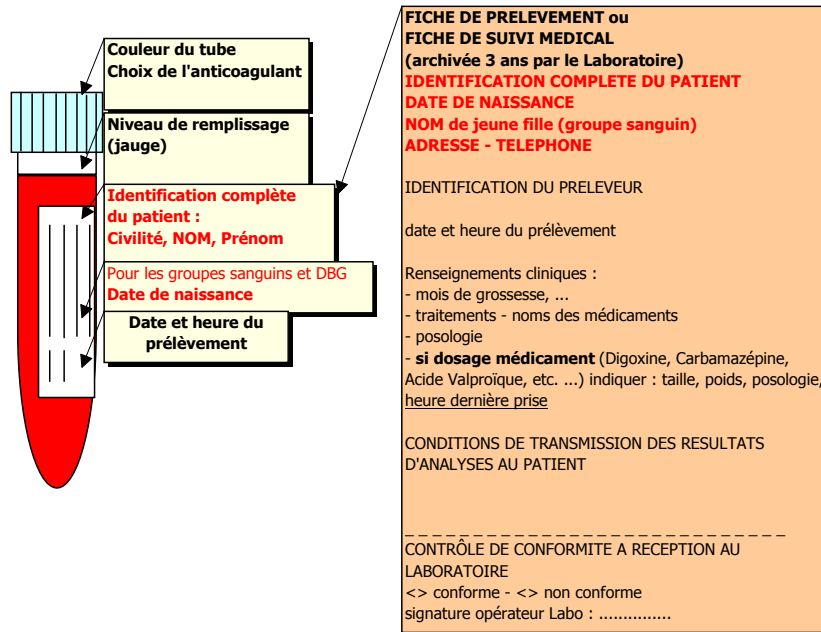

PRINCIPAUX MOTIFS DE REFUS DU PRELEVEMENT PAR LE LABORATOIRE EXIGENCES ABSOLUES NON RESPECTEES

Identification incomplète du prélèvement, voire absence d'identification
Absence sur le tube de la date de naissance pour le groupe sanguin rhésus
Tube échantillon non approprié (anticoagulant inadapté)
Echantillon de mauvaise qualité (remplissage insuffisant, coagulé, ...)

Les anomalies détectées à la réception du prélèvement au Laboratoire font l'objet d'une fiche de non-conformité adressée au préleveur et mentionnée sur le compte rendu d'analyses au médecin